


Rapport d'analyse – Sels nutritifs

Analysis report – Nutrients

Informations concernant le présent rapport dans le système management qualité <i>References of the present report in the system management quality</i>					
Auteur <i>Author</i>	Signature	FICHER (File)			
		Date	Lieu de stockage <i>(Storage)</i>	Réf. Fichier <i>Reference file</i>	Diffusion
François BAURAND		11 juillet 2008	SD US IMAGO Brest	FTDo_17_EGEE5.doc FTDo_17_EGEE5.pdf	libre

Informations générales

General information

Campagne océanographique : <i>Cruise</i>	EGEE 5	Chef de mission : <i>Chief Scientist :</i>		1 ^{er} leg & 2 ^{em} leg: F. MARIN	
Navire : <i>Research vessel</i>	n.o. L'ANTEA	Date de la mission: <i>Date of cruise :</i>		Juin 2007	
Nombre de stations hydrologiques <i>Number of hydrographic stations</i>	50	Nombre d'échantillons <i>Number of samples</i>		534	
Nom du Responsable des prélèvements : <i>Name of Chief</i>		1 ^{er} LEG		2 ^{em} LEG	
		François BAURAND			
Prélevés par : <i>Take by</i>	Quarts CTD <i>CTD Team</i> <input type="checkbox"/>	Equipe analytique <i>Analytical Team</i> <input checked="" type="checkbox"/>	Autre <i>Other</i> <input type="checkbox"/> :		
Type de flaconnage utilisé <i>Type of flask used</i>	30 ml PP <input checked="" type="checkbox"/>	125 ml PP <input type="checkbox"/>	30 ml PE <input type="checkbox"/>	125 ml PE <input type="checkbox"/>	Autre <i>Other</i>

Echantillons analysés en mer <i>Samples analysed on board</i>	OUI <i>Yes</i>	<input type="checkbox"/>	Echantillons Stockés <i>Samples stored</i>	OUI <i>Yes</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
	NON <i>No</i>	<input checked="" type="checkbox"/>		NON <i>No</i>	<input type="checkbox"/>

Si OUI, information sur échantillons stockés
If YES, information on the stored samples

Conditions de stockage <i>Conditions of storage</i>	
Pasteurisation <i>Pasteurisation</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
Empoisonnement HgCl ₂ <i>Mercury poisoning</i>	<input type="checkbox"/>
Congélation <i>Freezing</i>	<input type="checkbox"/>
Brut <i>Raw</i>	<input type="checkbox"/>
Autre : <i>Other :</i>	<input type="checkbox"/>

Conditions de transport des échantillons <i>Shippingmethod</i>	
Voies maritimes <i>By boat</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
Voies aériennes <i>By air</i>	<input type="checkbox"/>
Autre : <i>Other</i>	<input type="checkbox"/>
Temps de transport <i>Transport time</i>	2 MOIS
Observations :	

Informations analytiques

Analytical information

	Noms <i>Names</i>	Noms des laboratoires <i>Laboratory identity</i>
Responsable de l'analyse <i>Analysis manager</i>	François BAURAND	Laboratoire de chimie marine de Brest IRD - US 191 - IMAGO
Analystes : <i>Chemist</i>	G. CIORNEI	" " "
	F. BAURAND	" " "

Technique utilisée <i>Instrument</i>	Analyse par flux continu <i>By continuous flow</i>	OUI <i>Yes</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	Autre : <i>Other</i>
	Auto-analyseur AA3	OUI <i>Yes</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	Autre : <i>Other</i>
Paramètres analysés <i>Analysed parameters</i>		Méthodes utilisées <i>Used methods</i>		
<input checked="" type="checkbox"/>	Nitrite	Griess adapté par Benschneider & Robinson (1952)		<input checked="" type="checkbox"/>
		Autre :		
<input checked="" type="checkbox"/>	Nitrate	Griess adapté par Benschneider & Robinson (1952)		<input checked="" type="checkbox"/>
		Autre :		
<input checked="" type="checkbox"/>	Phosphate	Murphy & Riley (1962)		<input checked="" type="checkbox"/>
		Autre :		
<input checked="" type="checkbox"/>	Silicate	Mulin & Riley (1955) adaptée par Fanning & Pilson (1973)		<input checked="" type="checkbox"/>
		Autre :		
<input type="checkbox"/>	Ammonium	Berthelot adaptée par Solorzano (1969)		<input type="checkbox"/>
		Autre :		

Analyse des TESTS de précision et de reproductibilité

Precision and reproducibility

Stations "test"

Test Stations

Définition d'une station "test" : Station où *N* Bouteilles NISKIN sont prélevées à la même profondeur (*N*>2)

Definition of test station: station where *N* NISKIN bottles are taken at the same depth (*N*>2)

Des Stations "test" ont-elles été effectuées lors de la campagne ? <i>Are there test station carried out during the cruise?</i>	OUI <i>Yes</i>	<input type="checkbox"/>	Nb de Stations "test" <i>Number of test station</i>	-
	NON <i>No</i>	<input checked="" type="checkbox"/>		

Si OUI → analyse des stations "test" – If YES → study of test station

	NITRATE	PHOSPHATE	SILICATE
N° de station	-		
Pression moyenne (dbar)	-	-	-
Nombre d'échantillons	-	-	-
Concentrations moyennes ($\mu\text{mol.kg}^{-1}$)	-	-	-
Ecart-type ($\mu\text{mol. } \mu\text{mol.kg}^{-1}$)	-	-	-
C.V. (%)	-	-	-
C.V. (%) *pleine échelle WHP	*47 $\mu\text{mol. } \mu\text{mol. kg}^{-1}$	*5 $\mu\text{mol. } \mu\text{mol. kg}^{-1}$	*250 $\mu\text{mol. } \mu\text{mol. kg}^{-1}$
	-	-	-

Remarque : la concentration en NITRITE étant généralement négligeable, ce paramètre n'est pas utilisé pour étudier les résultats des stations "test"


Doublets bouteilles

Un doublet bouteilles correspond à 2 bouteilles NISKIN prélevées à la même profondeur pendant une même station.


Des doublets bouteilles ont-ils été effectués lors de la campagne ?	OUI Yes	<input checked="" type="checkbox"/>	NON No	<input type="checkbox"/>
---	------------	-------------------------------------	-----------	--------------------------

Si OUI analyse des doublets


	NITRITE	NITRATE	PHOSPHATE	SILICATE
Nombre de doublets	43	43	43	43
Moyenne des écarts	0.00	-0.12	-0.01	-0.12
Écart type des écarts	0.02	0.32	0.02	0.33
Écart maximum	-0.05	-0.5	0.06	0.5

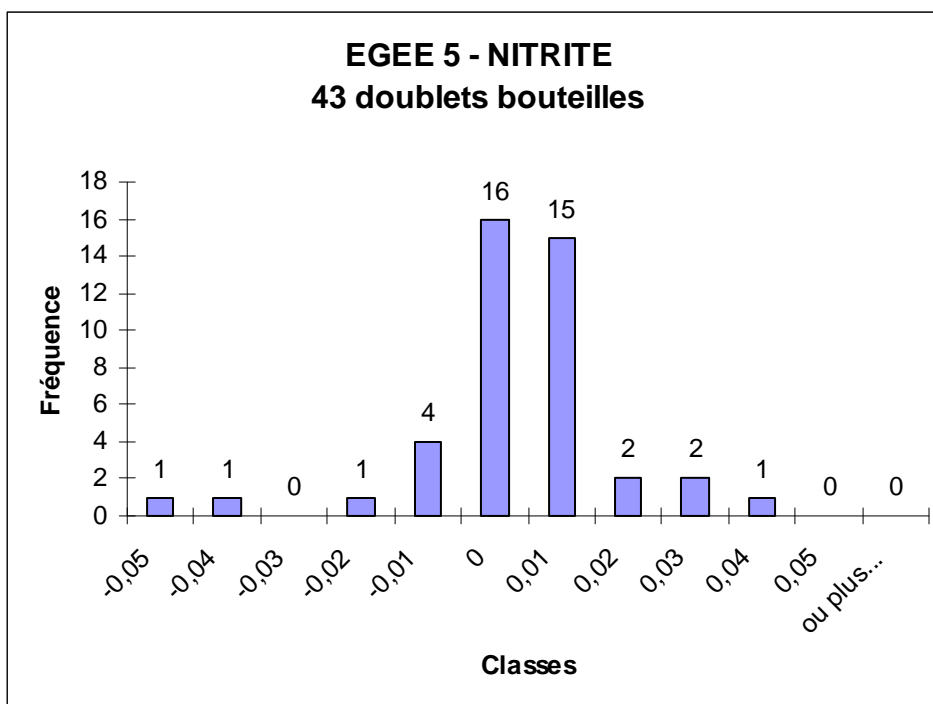


Histogramme de répartition des écarts des doublets bouteilles en nitrite

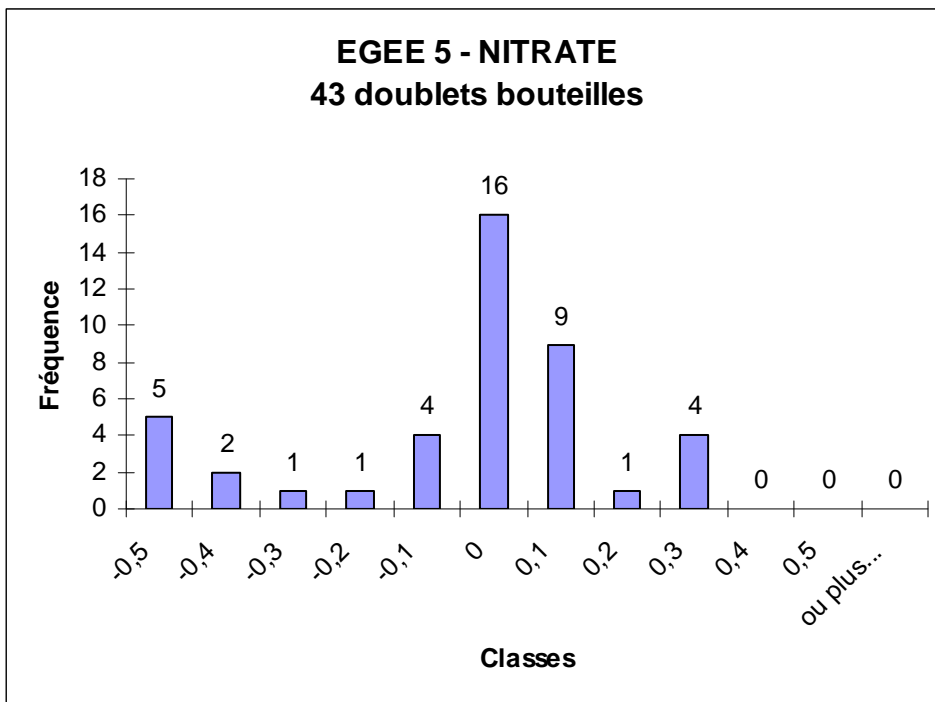

Histogramme de répartition des écarts des doublets bouteilles en nitrate



Histogramme de répartition des écarts des doublets bouteilles en phosphate

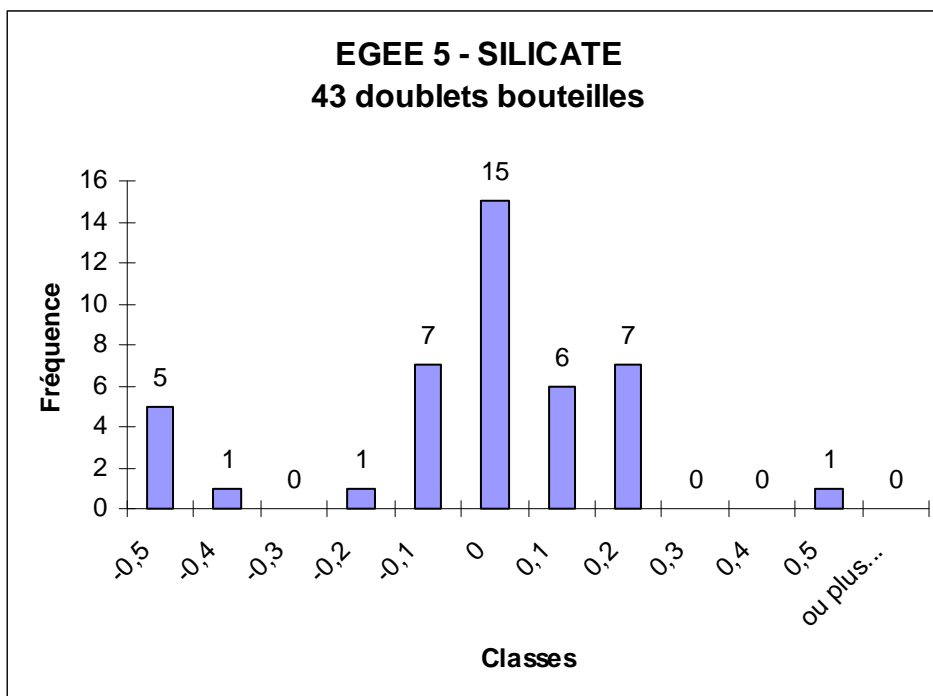

Histogramme de répartition des écarts des doublets bouteilles en silicate

Doublets échantillons

Un doublet échantillons correspond à 2 prélèvements sels nutritifs (deux flacons) sur la même bouteille NISKIN lors d'une même station.

Des doublets échantillons ont-ils été effectués lors de la campagne ?	OUI Yes	<input type="checkbox"/>	NON No	<input checked="" type="checkbox"/>
---	------------	--------------------------	-----------	-------------------------------------

Si OUI analyse des doublets

	NITRITE	NITRATE	PHOSPHATE	SILICATE
Nombre de doublets	-	-	-	-
Moyenne des écarts	-	-	-	-
Écart type des écarts	-	-	-	-
Écart maximum	-	-	-	-

Analyse des données

Les résultats d'analyses exprimés en micromoles par litre ($\mu\text{mol.l}^{-1}$) sont ensuite convertis en micromoles par kilogramme ($\mu\text{mol.kg}^{-1}$) d'eau de mer en prenant comme température de l'échantillon au moment de l'analyse 25 °C (température moyenne du laboratoire) et une salinité moyenne de 35 pour tous les échantillons. La masse volumique ρ de l'eau de mer à 25°C et pour une salinité de 35 à 1 atmosphère est de 1.02334306 g/cm^3 selon l'équation suivante :

$$\rho_{\text{sw}} = \rho_{\text{w}} + AS + BS^{1.5} + CS^2$$

où S est la salinité (35) et t la température en °C (25), et :

$$\rho_{\text{w}} = 0.999842594 + 6.793952 \times 10^{-5} t - 9.095290 \times 10^{-6} t^2 + 1.001685 \times 10^{-7} t^3 - 1.120083 \times 10^{-9} t^4 + 6.536332 \times 10^{-12} t^5$$

$$A = 8.24493 \times 10^{-4} - 4.0899 \times 10^{-6} t + 7.6438 \times 10^{-8} t^2 - 8.2467 \times 10^{-10} t^3 + 5.3875 \times 10^{-12} t^4$$

$$B = -5.72466 \times 10^{-6} + 1.0227 \times 10^{-7} t - 1.6546 \times 10^{-9} t^2$$

$$C = 4.8314 \times 10^{-7}$$

Prélèvement bouteille douteux

Un prélèvement bouteille est dit douteux, lorsque sa concentration pour l'ensemble des paramètres géochimiques présente une aberration sur le profil correspondant.

Présence de prélèvements douteux	OUI Yes	<input type="checkbox"/>	NON No	<input checked="" type="checkbox"/>
----------------------------------	------------	--------------------------	-----------	-------------------------------------

Si OUI, identification des prélèvements douteux

N° Station	N° bouteille	Diagnostiques possibles			
		Fuite sur bouteille	Pollution bouteille	Erreur de profondeur	Autre
-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Echantillon douteux

Un échantillon est dit douteux, lorsque sa concentration pour l'un des TROIS (nitrate, phosphate et/ou silicate) présente une aberration sur le profil correspondant.

Présence d'échantillon douteux	OUI	<input type="checkbox"/>	NON	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------	-----	--------------------------	-----	-------------------------------------

Si OUI, identification des échantillons douteux

N° Station	N° bouteille	Paramètre concerné			Diagnostiques possibles			
		NO ₃	PO ₄	SiO ₃	Erreur prélèvement	Pollution flacon	Problème analytique	Autre
-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Observations

Niveaux moyens ciblés lors de la campagne

N° Stations	N° bouteilles	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Doublets
1 à 10	Pressions	500	300	100	80	60	40	20	10	surf	-	oui
11 à 49	Pressions	1000	500	300	100	80	60	40	20	10	surf	oui

Stations dont les niveaux de prélèvements ne répondent pas aux niveaux moyens habituellement ciblés.

N° Stations	N° bouteilles	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Pressions	2000	1500	1000	500	100	76	60	35	19	10	surface
33	Pressions	2000	1500	1000	500	-	78	60	40	19	9	surface
37	Pressions	2000	1500	1000	500	100	72	58	39	19	10	surface
47	Pressions	2000	1500	1000	500	100	79	60	39	19	8	surface
50	Pressions	2000	1500	1000	500	100	80	59	39	19	10	surface

Lors des stations hydrologiques, certains niveaux n'ont pas été échantillonnés en vue de l'analyse des sels nutritifs. Il n'existe donc pas de résultats de sels nutritifs pour ces niveaux.

N° Stations	N° bouteilles	Pressions	Observations relevées sur feuilles de prélèvements CDD
2	11	-	Bouteille volontairement non déclenchée (seulement 10 niveaux)
3	11	-	" " "
4	11	-	" " "
4	10	surface	Bouteille non fermée
6	5	60	Pas assez d'eau pour prélèvement sels nutritifs
9	7	30	Bouteille réservée pour les prélèvements d'Ajit
25	9	20	Rien à signaler sur la feuille de prélèvements mais pourtant il n'y a pas d'échantillons de prélevés et donc à analyser
25	10	10	
25	11	surface	
33	5	99	Bouteille non fermée
34	5	100	" " "

